Struers
Ensuring Certainty

LaboDoser-10

Manuale d'uso

Traduzione di istruzioni originali

Doc. N.: 16377026-02_C-it
Data di rilascio: 2025.04.04

Copyright

I contenuti di questo manuale sono proprietà di Struers ApS. La riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale senza l'autorizzazione scritta di Struers ApS non è consentita.

Tutti i diritti sono riservati. © Struers ApS.

Indice

1 Informazioni sul presente manuale **4**

2 Guida introduttiva **4**

2.1 Descrizione del dispositivo 4

2.2 Controllare la distinta di imballaggio 5

2.3 Disimballare la macchina 5

3 Installazione **6**

4 Funzionamento di LaboDoser-10 ..... **7**

5 Cambiare la sospensione diamantata/lubrificante **8**

6 Manutenzione **8**

7 Produttore **8**

1 Informazioni sul presente manuale

ATTENZIONE
L'apparecchiatura Struers dev'essere utilizzata esclusivamente come descritto nel Manuale d'uso in dotazione.

Nota
Leggere attentamente il Manuale d'uso prima dell'utilizzo.

Nota
Per informazioni più dettagliate, consultare la versione online di questo manuale.

2 Guida introduttiva

2.1 Descrizione del dispositivo

LaboDoser-10 montato su LaboPol

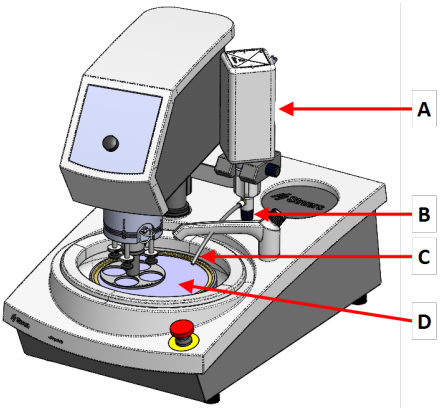

A LaboDoser-10 bottiglia di sospensione diamantata/lubrificante
B Valvola regolabile
C Ugello dosatore
D Disco di preparazione

LaboDoser-10 montato su un supporto da tavolo LaboDoser-10

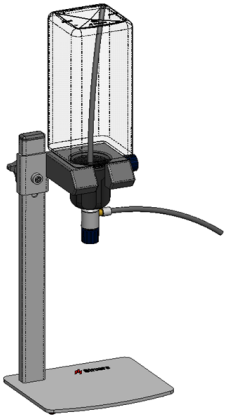

2.2 Controllare la distinta di imballaggio

Nella confezione sono presenti i seguenti articoli:

Pz.	Descrizione
1	Unità LaboDoser-10 con bottiglia da 1,0 litri
1	Tubo di aspirazione per bottiglia da 0,5 litri
1	Strumento per la rimozione dell'inserto del connettore Easy
1	Chiave a brugola da 3 mm
1	Staffa per braccio dosatore
2	Viti esagonali
1	Set di Manuali d'uso

2.3 Disimballare la macchina

Nota
Si consiglia di conservare tutti gli imballaggi e accessori originali per un utilizzo futuro.

1. Tagliare il nastro d'imballaggio sulla parte superiore della scatola.
2. Rimuovere le parti sfuse.
3. Rimuovere l'unità dalla scatola.

3 Installazione

Suggerimento
Se si prevede di non utilizzare sospensioni diamantate/lubrificanti per un lungo periodo di tempo, rimuovere la bottiglia dal supporto e conservarla in posizione verticale.

LaboDoser-10 può essere montato sulla colonna delle seguenti unità:

- LaboUI
- LaboForce-50
- LaboForce-Mi

Procedura

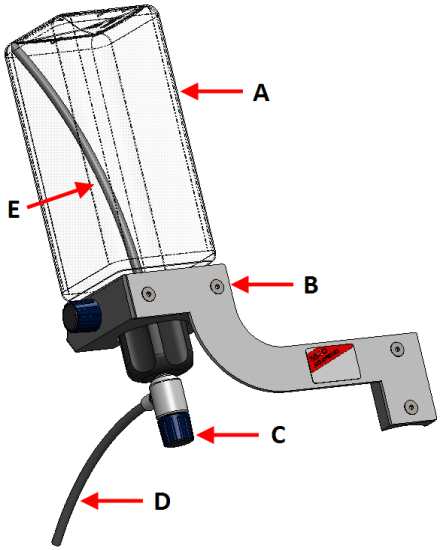

A Bottiglia di sospensione diamantata/lubrificante
B Braccio dosatore
C Valvola regolabile
D Ugello dosatore
E Tubo di aspirazione

1. Utilizzare la staffa e le due viti per montare il braccio dosatore sulla colonna della macchina.
2. Quando si utilizza una nuova bottiglia di sospensione diamantata/lubrificante, togliere il coperchio e utilizzare lo strumento per rimuovere l'inserto del connettore Easy sulla bottiglia.



3. Il tappo LaboDoser-10 è dotato di tubo di aspirazione (**A**) per bottiglie da 1,0 litri.
   Se si utilizza una bottiglia da 0,5 litri, passare al tubo corto (**B**).

> **Nota**
> Assicurarsi di montare il tubo con l'estremità ad angolo rivolta verso il basso.

4. Fissare il tappo della bottiglia con valvola regolabile su una bottiglia di sospensione diamantata/lubrificante Struers.
5. Inserire la bottiglia nel braccio dosatore.

4 Funzionamento di LaboDoser-10

L'operatore regola la valvola per erogare la quantità necessaria di sospensione diamantata/lubrificante sul disco di preparazione.

1. Posizionare l'ugello dosatore in posizione ottimale sul disco di preparazione.
2. Aprire la valvola e regolare il livello di dosaggio della sospensione diamantata/lubrificante.

3. Una volta completata la fase di preparazione, chiudere la valvola per interrompere il dosaggio.

5 Cambiare la sospensione diamantata/lubrificante

Struers raccomanda di utilizzare un tappo diverso per ogni bottiglia di consumabile.

Per utilizzare il tappo della bottiglia per un altro consumabile:

1. Rimuovere la bottiglia.
2. Tenere saldamente la bottiglia e rimuovere il tappo.
3. Svuotare la bottiglia e riempirla con una soluzione saponata delicata.
4. Aprire la valvola e ripulire l'ugello dosatore.
5. Sciacquare con acqua pulita e ripetere la procedura.
6. Mettere il tappo della bottiglia sulla bottiglia di sospensione diamantata/lubrificante Struers.

6 Manutenzione

Se LaboDoser-10 è rimasto inutilizzato a lungo, si consiglia di pulirlo prima di utilizzarlo e di rimuovere eventuali sospensioni diamantate/lubrificanti essiccati.

7 Produttore

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Danimarca
Telefono: +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Responsabilità del produttore

Le seguenti regole devono sempre essere osservate, la loro violazione potrebbe causare la cancellazione degli obblighi legali da parte di Struers.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel testo e/o nelle illustrazioni del presente manuale. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Il manuale potrebbe menzionare accessori o parti non incluse nella presente versione del dispositivo.

Il produttore deve essere considerato responsabile degli effetti su sicurezza, affidabilità e prestazioni dell'apparecchiatura solo se questa viene utilizzata, sottoposta ad assistenza e manutenzione in conformità alle istruzioni per l'uso.

Struers
Ensuring Certainty

en	For translations see
bg	За преводи вижте
cs	Překlady viz
da	Se oversættelser på
de	Übersetzungen finden Sie unter
el	Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es	Para ver las traducciones consulte
et	Tõlked leiate aadressilt
fi	Katso käännökset osoitteesta
fr	Pour les traductions, voir
hr	Za prijevode idite na
hu	A fordítások itt érhetők el
it	Per le traduzioni consultare
ja	翻訳については、
lt	Vertimai patalpinti
lv	Tulkojumus skatīt
nl	Voor vertalingen zie
no	For oversettelser se
pl	Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt	Consulte as traduções disponíveis em
ro	Pentru traduceri, consultați
se	För översättningar besök
sk	Preklady sú dostupné na stránke
sl	Za prevode si oglejte
tr	Çeviriler için bkz
zh	翻译见

www.struers.com/Library